

醫用磁振學

MR Angiography

放射線器材學

1. 有關使用相位對比 (phase contrast) 技術測量血液流速的血管磁振造影，下列敘述何者錯誤？
 - A.需使用 bipolar gradient 產生相位差
 - B.相位與流速呈反比
 - C.需預估最大流速，以避免產生 phase aliasing
 - D.造影高速血流時，應使用較小之梯度磁場

(B, 108 年第二次放射線器材學第 37 題)

2. 下列關於相位對比磁振血管攝影 (phase contrast MRA) 的敘述何者錯誤？
 - A.在自旋回聲 (spin echo) 脈衝序列中，是在 90° 及 180° RF 間及 180° RF 後各加上一正一負等面積的梯度
 - B.在梯度回聲 (gradient echo) 脈衝序列中，是在 RF 後額外加上一正一負等面積的流體編碼梯度
 - C.靜止的質子在 TE 時同相位 (in phase)
 - D.速度為常數的流動質子在 TE 時相位與速度相關

(A, 100 年第二次放射線器材學第 40 題)

3. 下列關於磁振血管攝影 (MRA) 的敘述何者正確？
 - A.飛行時間磁振血管攝影 (TOF MRA) 需要預測最大的流體速度
 - B.飛行時間磁振血管攝影 (TOF MRA) 是用梯度回聲 (gradient echo) 脈衝序列，在 RF 後加上一正一負等面積的流體編碼梯度
 - C.相位對比磁振血管攝影 (PC MRA) 中，速度為常數的流動質子經過一正一負等面積的流體編碼梯度後，相位與速度成正比
 - D.相位對比磁振血管攝影 (PC MRA) 只能用在 2D，不能用在 3D

(C, 100 年第一次放射線器材學第 44 題)

放射線診斷原理與技術學

4. 在 spin echo sequence 中，下列何者會影響 time of flight (TOF) 的現象？
 - A.phase encoding steps
 - B.slice thickness
 - C.flip angle
 - D.TR

(B, 113 年第二次放射線診斷原理與技術學第 51 題)

5. 下列何種方式無法得到大腦的靜脈影像？

A.TOF MRA presaturation band 放頭的上方

- B.3D phase contrast MRV
- C.contrast-enhanced MRA, delayed phase
- D.minimum intensity projection (MinIP) of susceptibility-weighted imaging (SWI)

(A, 113 年第二次放射線診斷原理與技術學第 44 題)

6. 為了產生三維 (3D) phase contrast (PC) MR 血管攝影，至少需要多少組圖像？
- A.2
 - B.4
 - C.6
 - D.8

(C, 113 年第一次放射線診斷原理與技術學第 43 題)

7. 使用相位對比 (phase contrast) 磁振造影技術測量血液流速時，若產生 velocity-encoding (VENC) aliasing，則可使用下列何種方法去除此現象？
- A.提高 VENC 的設定值
 - B.降低 VENC 的設定值
 - C.關掉 VENC
 - D.增加 field of view (FOV)

(A, 112 年第二次放射線診斷原理與技術學第 51 題)

8. 關於磁振造影多重疊薄區塊擷取技術 (MOTSA) 的敘述，下列何者正確？
- A.2D-TOF 和 3D-TOF 的組合技術
 - B.2D-PC 和 3D-TOF 的組合技術
 - C.2D-PC 和 3D-PC 的組合技術
 - D.2D-TOF 和 3D-PC 的組合技術

(A, 112 年第一次放射線診斷原理與技術學第 48 題)

9. 下列何者為 inflow MRA 之優點？
- A.lower resolution
 - B.sensitive to slow flow
 - C.saturation of in-plane flow
 - D.venetian blind artifact

(B, 111 年第二次放射線診斷原理與技術學第 53 題)

10. 下列何者為 MRI 的內在對比參數 (intrinsic contrast parameter) ？
- A.flip angle
 - B.flow
 - C.TE
 - D.b value


(B, 111 年第二次放射線診斷原理與技術學第 50 題)

11. 下列何種 MR angiography 技術具有較快速、較不受 turbulent flow 影響且 signal-to-noise ratio (SNR) 高的優勢？

- A.contrast-enhanced MRA
- B.2D time-of-flight (TOF) MRA
- C.3D time-of-flight (TOF) MRA
- D.phase-contrast (PC) MRA

(A, 111 年第二次放射線診斷原理與技術學第 48 題)

12. 如下圖，在這組 2D TOF MRA 上面的每一張影像，左邊的椎動脈都沒有訊號，下列何者為可能的結論？

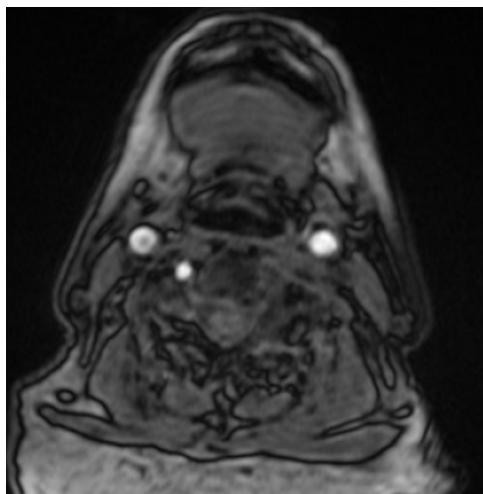

- A.可以確定是血管阻塞
- B.可能有 turbulent flow
- C.是因為 flow void
- D.可能是逆向的 flow

(D, 111 年第二次放射線診斷原理與技術學第 46 題)

13. 在 phase contrast (PC) MR 血管攝影中，固定不動的組織在灰階相位影像是什麼顏色？

- A.白
- B.灰
- C.黑
- D.黑、白、灰都有可能

(B, 111 年第二次放射線診斷原理與技術學第 43 題)

14. 下圖影像箭號處的黑點成因為何？



- A. flow void in a normal patent vessel
- B. flow related enhancement
- C. occluded vessel
- D. microbleed

(A, 111 年第一次放射線診斷原理與技術學第 49 題)

15. 當使用 gadolinium 標記的顯影劑進行 MR 血管攝影時，下列何者不會被顯影？
- A. 靜脈
 - B. 動脈
 - C. 總膽管
 - D. 門靜脈

(C, 110 年第二次放射線診斷原理與技術學第 44 題)

16. 相對於 contrast enhanced MR angiography，下列何者是 time-of-flight MR angiography 的優點？
- A. 成像時間較短
 - B. 可提供所有血流方向訊息
 - C. 不容易受靜脈訊號污染
 - D. 可和亞急性血塊分辨

(C, 110 年第一次放射線診斷原理與技術學第 52 題)

17. 相對於 2D-TOF MRA，有關 3D-TOF MRA 的敘述，下列何者錯誤？
- A. 對 slow flow 之偵測較靈敏
 - B. 訊雜比較高
 - C. 成像時間較久
 - D. 空間解析度較佳

(A, 109 年第二次放射線診斷原理與技術學第 49 題)

18. 腦部的動靜脈畸形在 T1-weighted image 上可能呈現下列何種血流現象？① flow related enhancement ②flow void

- A.只有①會出現
- B.只有②會出現
- C.①、②皆有
- D.①、②皆無

(C, 109 年第二次放射線診斷原理與技術學第 50 題)

19. 要測量血管中的血流速度，可使用下列何種 MRA？

- A.2D PC (phase contrast)
- B.3D TOF (time-of-flight)
- C.2D TOF (time-of-flight)
- D.contrast-enhanced

(A, 109 年第一次放射線診斷原理與技術學第 49 題)

20. 下列何種造影技術可以不使用造影劑就能得到血管的影像？

- A.CTA
- B.TOF-MRA
- C.DSA
- D.conventional angiography


(B, 109 年第一次放射線診斷原理與技術學第 55 題)

21. 有關對比增強磁振血管造影術 (contrast-enhanced MR angiography) 的敘述，下列何者正確？

- A.其取像平面通常是與血管走向呈 90 度
- B.是一種 T2 加權影像技術
- C.與相位對比磁振血管造影術 (phase-contrast MR angiography) 相比，一般而言，其訊雜比 (SNR) 比較差
- D.與疾行時間磁振血管造影術 (time-of-flight MR angiography) 相比，比較不受擾流 (turbulent flow) 引起的去相效應 (dephasing effect) 的影響

(D, 106 年第二次放射線診斷原理與技術學第 47 題)

22. 下圖為腦部 MRA，箭號所指為何？

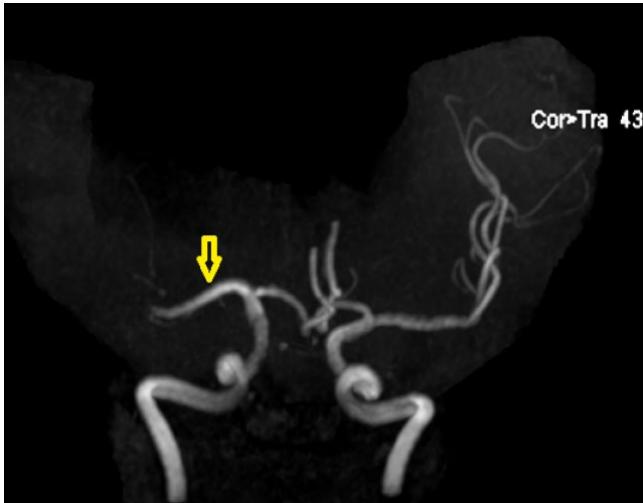

- A.前腦動脈
- B.中腦動脈
- C.後腦動脈
- D.內頸動脈

(B, 106 年第二次放射線診斷原理與技術學第 46 題)

23. 下列何者為磁振血管造影 (MRA) 最常用的成像波序？

- A.spin echo
- B.STIR
- C.gradient echo
- D.FLAIR

(C, 106 年第二次放射線診斷原理與技術學第 40 題)

24. 下列何種磁振造影技術可用於檢查腦脊髓液 (cerebrospinal fluid) 的流速？

- A.二維-疾行時間磁振血管造影術 (2D time-of-flight MR angiography)
- B.二維-相位對比磁振血管造影術 (2D phase-contrast MR angiography)
- C.三維-疾行時間磁振血管造影術 (3D time-of-flight MR angiography)
- D.三維-對比增強磁振血管造影術 (3D contrast-enhanced MR angiography)

(B, 105 年第二次放射線診斷原理與技術學第 50 題)

25. 下列何者不是 MRI 的血管攝影技術？

- A.diffusion tensor imaging
- B.time of flight
- C.phase contrast
- D.contrast enhanced

(A, 105 年第二次放射線診斷原理與技術學第 51 題)

26. 下列何者不是顱內磁振血管造影 (MRA) 使用的技術？

- A.time-of-flight
- B.phase contrast

C.contrast-enhanced

D.echo planar

(D, 104 年第一次放射線診斷原理與技術學第 52 題)

27. 相位對比磁振血管造影 (phase contrast MR angiography) 的優點為：

- A. 血管較彎處的失相較不敏感
- B. 取像時間較短
- C. 對擾流造成的訊號喪失較不敏感
- D. 背景的壓抑較好

(D, 101 年第一次放射線診斷原理與技術學第 47 題)

28. 要測量血管中的血流速度應使用下列何者？

- A. 3D TOF (time-of-flight) MRA
- B. 2D TOF MRA
- C. CE (contrast enhanced) MRA
- D. 2D PC (phase contrast) MRA

(D, 97 年第一次放射線診斷原理與技術學第 47 題)

29. 使用飛躍時間磁振血管造影技術時，可採用下列何種方法提高細微血管的偵測能力？

- A. 增加切面厚度
- B. 減少切面厚度
- C. 增加重複時間 (TR)
- D. 減少重複時間 (TR)

(B, 97 年第一次放射線診斷原理與技術學第 48 題)

30. 關於 MRA 何者正確？

- A. TOF MRA 血流外信號強的組織（如血塊，脂肪，腦下垂體後葉）易與血流混淆
- B. PC MRA 周圍之脂肪組織常呈高信號；如血管
- C. TOF MRA 使用 subtraction technique 成像
- D. PC MRA 使用 MIP 成像

(A, 96 年第一次放射線診斷原理與技術學第 37 題)

31. 關於 2D-TOF 與 3D-TOF MRA 下列何者正確？

- A. 3D-TOF MRA 之 SNR 比較低
- B. 3D-TOF MRA 對 slow flow 之偵測比較敏感
- C. 2D-TOF MRA 比較快
- D. 2D-TOF MRA 之 spatial resolution 比較好

(C, 96 年第一次放射線診斷原理與技術學第 52 題)

32. 下列何者不是影響 time of flight 作用大小的因素？

- A.FOV 大小
- B.TE 長短
- C.切片厚度
- D.速度

(A, 95 年第一次放射線診斷原理與技術學第 46 題)

33. 下列何者不是 contrast enhanced MR angiography 的缺點？

- A.訊雜比低
- B.無法提供血流方向訊息
- C.需要掌握時間，避免假影或靜脈污染
- D.需要注射顯影劑，較費成本且具輕微侵入性

(A, 95 年第一次放射線診斷原理與技術學第 53 題)